

QAngio XA 8.0

Kurzanleitung



Medis Medical Imaging Systems bv
Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden, Niederlande



<http://www.medisimaging.com>

Wählen Sie auf der Medis-Website „Produkte“ und dann die entsprechende Produktgruppe aus. Die Benutzerdokumentation finden Sie auf dieser Seite.

Für den Zugriff auf die Benutzerdokumentation ist ein PDF-Reader erforderlich. Wenn auf dem System kein PDF-Reader installiert ist, können Sie den kostenlosen Adobe-Reader herunterladen. Besuchen Sie die Adobe-Website unter <https://get.adobe.com/reader/> und klicken Sie auf "Adobe Reader herunterladen", um den PDF-Reader herunterzuladen.

Medis Medical Imaging Systems bv
Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden
P.O. Box 384, 2300 AJ Leiden, Niederlande
Tel.: +31 71 522 32 44
Fax: +31 71 521 56 17
E-Mail: support@medisimaging.com

Medis Medical Imaging Systems, Inc.
9360 Falls of Neuse Road, Suite 103
Raleigh, NC 27615-2484, USA
Tel.: +01 (919) 278 7888
Fax: +01 (919) 847 8817
E-Mail: support@medisimaging.com

Rechtliche Hinweise

Copyright-Vermerk

©1997-2021 Medis Medical Imaging Systems bv. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch unterliegt dem Urheberrecht und ist durch weltweite Urheberrechtsgesetze und Vertragsbestimmungen geschützt. Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch Medis Medical Imaging Systems bv darf kein Teil dieses Handbuchs in irgendeiner Form und zu keinem Zweck kopiert, reproduziert, geändert, veröffentlicht oder verteilt werden. Das Drucken von Kopien ist gestattet und unentgeltlich, insoweit die Kopien vollständig und unverändert sind und nicht erzeugt oder verteilt werden, um daraus Profit oder geschäftlichen Vorteil zu ziehen.

Anerkennung von Marken

QAngio ist eine eingetragene Marke der Medis Associated B.V. DICOM ist die eingetragene Marke der National Electrical Manufacturers Association für deren Veröffentlichungen von Standards in Bezug auf die digitale Kommunikation medizinischer Daten. Microsoft und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in diesem Dokument verwendeten Marken-, Produkt- und Firmennamen sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber.

Gesetzliche Vorschriften

Verwendungszweck

QAngio XA ist eine Software zur Durchführung von Berechnungen in röntgenangiografischen Bildern der Herzkammern und der Blutgefäße. Diese Berechnungen basieren auf Konturen, die entweder manuell vom Krankenhausarzt oder von einem geschulten Medizintechniker, der die Software bedient, erstellt wurden oder automatisch von der Software erkannt und anschließend zur Prüfung und manuellen Bearbeitung präsentiert werden. QAngio XA ist auch zur Durchführung von Messungen vorgesehen. Die ermittelten Ergebnisse werden oben in den Bildern angezeigt und auch in Berichten ausgewiesen.

Die mit QAngio XA erhaltenen Analyseergebnisse sind für den Einsatz durch Kardiologen und Radiologen bestimmt:

- um klinische Entscheidungen in Bezug auf Herz und Gefäße zu unterstützen
- zur Unterstützung der Bewertung von Interventionen oder medikamentösen Therapien bei Erkrankungen des Herzens und der Gefäße

Indikationen für die Anwendung

QAngio XA ist zur Anwendung in klinischen Umgebungen indiziert, in denen validierte und reproduzierbare quantifizierte Ergebnisse erforderlich sind, um die Berechnungen in röntgenangiografischen Bildern der Kammern des Herzens und der Blutgefäße zu unterstützen, um sie bei einzelnen Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verwenden.

Wenn die von QAngio XA gelieferten quantifizierten Ergebnisse in einer klinischen Umgebung für Röntgenbilder eines einzelnen Patienten verwendet werden, können sie zur Unterstützung des klinischen Entscheidungsfindungsprozesses für die Diagnose des Patienten oder die Beurteilung der Therapie eingesetzt werden. In diesem Falle sind die Ergebnisse ausdrücklich nicht als alleinige, unwiderlegbare Grundlage für die klinische Diagnose zu betrachten und dürfen nur von den jeweils verantwortlichen Klinikärzten verwendet werden.

WARNUNGEN

❗ QAngio XA darf nur von Kardiologen, Radiologen oder anderen Personen eingesetzt werden, die für die Durchführung von Herzanalysen qualifiziert sind. Werden die Analyseergebnisse zur Stellung einer Diagnose verwendet, müssen sie von einem qualifizierten Arzt interpretiert werden. QAngio XA darf in der klinischen Praxis zu keinen anderen Zwecken eingesetzt werden als den im Abschnitt „Verwendungszweck“ aufgeführten.

❗ Benutzer müssen über ausreichende Kenntnisse der ausgewählten Betriebssystemsprache verfügen, dieses Handbuch lesen und sich mit der Software vertraut machen, bevor sie QAngio XA in einer klinischen Umgebung verwenden können, um zuverlässige Analyseergebnisse zu erhalten.


❗ Es ist der angiographischen Methode und der Modellierung des ventrikulären Volumens inhärent, dass QAngio XA das enddiastolische Volumen des rechten Ventrikels bei vergrößerten linken Ventrikeln stark überschätzen kann.

❗ QAngio XA kann bei schlechten Kontrastfüllungen das Volumen großer rechter Ventrikel mit ausgedehnten Trabekeln unterschätzen.

Anmerkung zu Bildformat und Auflösung des Bildschirms

⚠ Die Formen der angezeigten Objekte und Messungen können leicht verzerrt werden, wenn die Auflösung auf ein anderes Seitenverhältnis als das physikalische Seitenverhältnis des Monitors eingestellt wird. Diese Verzerrung beeinträchtigt **NICHT** die Genauigkeit von Messungen oder Analysen. Um Verzerrungen zu vermeiden, stellen Sie die Auflösung des Monitors auf ein Seitenverhältnis ein, das dem physischen Seitenverhältnis entspricht. LCD-Monitore arbeiten normalerweise am besten mit ihrer nativen Auflösung. Microsoft Windows empfiehlt eine Auflösung, wenn ausreichend Informationen vorhanden sind.

Europäische Vorschriften

 <p>CE 1639</p>	<p>QAngio XA ist als medizintechnisches Gerät der Klasse IIa klassifiziert. Es erfüllt die Anforderungen der holländischen Medizingeräterichtlinie („Besluit Medische Hulpmiddelen“, Stb. 243/1995) und der europäischen Medizingeräterichtlinie 93/42/EWG.</p>
--	---

Nordamerikanische Vorschriften

QAngio XA ist gemäß den Bestimmungen in Abschnitt 510(k) des Food, Drug, and Cosmetic Act der FDA (Food and Drug Administration) für den Markt in den Vereinigten Staaten zugelassen.

Achtung

Laut Gesetzgeber ist der Verkauf dieses Geräts ausschließlich auf ärztliche Anordnung zulässig.

QAngio XA erfüllt die Anforderungen der der Canadian Medical Devices Regulations und wurde als medizinisches Gerät der Klasse II lizenziert.

Asien-Pazifik-Vorschriften

QAngio XA erfüllt die Anforderungen der Australian Therapeutic Goods Administration und wurde als Medizinprodukt der Klasse IIa lizenziert.

QAngio XA erfüllt die Anforderungen des Japanese Pharmaceutical and Medical Device Law und wurde als medizinisches Gerät der Klasse II lizenziert.

QAngio XA erfüllt die Anforderungen des South Korean Medical Device Act und wurde als medizinisches Gerät der Klasse II lizenziert.

In diesem Handbuch verwendete Konventionen

Die folgenden Konventionen werden in diesem Handbuch verwendet, um die Verwendung der Maus oder Tastatur zu kennzeichnen sowie zur Bezugnahme auf Elemente der Benutzeroberfläche.

Maus

Klick	Drücken Sie die primäre Maustaste und lassen Sie sie wieder los. Wenn Sie Linkshänder sind, haben Sie möglicherweise die rechte Maustaste als primäre Maustaste belegt.
Klicken und ziehen	Halten Sie die primäre Maustaste gedrückt. Ziehen Sie die Maus, um eine Funktion auszuführen. Lassen Sie die primäre Maustaste los. Wenn Sie Linkshänder sind, haben Sie möglicherweise die rechte Maustaste als primäre Maustaste belegt.
Rechtsklick	Drücken Sie kurz die sekundäre Maustaste. Wenn Sie Linkshänder sind, haben Sie möglicherweise die linke Maustaste als sekundäre Maustaste belegt.
Mittelklick	Drücken Sie kurz die Radtaste oder die mittlere Maustaste. Wenn Sie eine Zwei-Tasten-Maus haben, drücken Sie die linke und rechte Maustaste gleichzeitig und lassen sie gleichzeitig los.
Doppelklick	Drücken Sie zweimal die primäre Maustaste und lassen Sie sie los.
Mausrad	Drehen Sie das Mousrad.

Tastatur

UMSCHALT + Klicken	Halten Sie die UMSCHALTTASTE auf Ihrer Tastatur gedrückt, während Sie auf eine Schaltfläche oder ein Objekt klicken.
STRG-Taste + K	Drücken und halten Sie auf Ihrer Tastatur die STRG gedrückt, während Sie die Taste K drücken, und lassen Sie beide Tasten anschließend los.

Typographische Konventionen

Auf dem Knoten Anmerkungen des Fensters Arbeitsabläufe...	Namen von Schaltflächen, Feldern, Menüs, Menüoptionen und Registerkartennamen werden groß und fett gedruckt.
Arbeitsabläufe > Textanmerkung	Eine Abfolge von Menüoptionen, die gewählt werden muss, um eine bestimmte Aufgabe durchzuführen, wird durch rechteckige Klammern angezeigt.

Bezeichnung: Aortenwurzel

Text, den Sie eingeben oder der auf dem Bildschirm angezeigt wird, z.B. Anmerkungsbezeichnungen, wird in `Courier New` angezeigt.

Verwendete Symbole



Tipp: Liefert hilfreiche Informationen oder eine alternative Vorgehensweise.



Hinweis: Macht Sie auf zusätzliche Informationen aufmerksam.



Achtung: Weist Sie an, beim Durchführen einer Aufgabe Vorsicht walten zu lassen.



Warnung: Warnt Sie vor einer potenziell gefährlichen Situation bei Bilddarstellung oder Bildanalyse, die zu fehlerhaften Ergebnissen führen kann. Um dies zu vermeiden ist ein Befolgen der Anweisungen unerlässlich.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	11
1 Über QAngio XA	11
2 Systemanforderungen	12
2.1 Hardware	12
2.2 Betriebssystem.....	12
3 Kundendienst.....	13
Erste Schritte.....	14
4 Start aus der Medis Suite.....	14
5 QAngio XA Arbeitsbereich	15
5.1 Übersicht	15
5.2 Menü	16
5.3 Werkzeugleiste	16
Arbeiten mit QAngio XA.....	17
6 Betrachten	17
6.1 Monoplanare und biplanare Ansicht	17
6.2 Bild-Ansichtsfenster	17
6.3 EKG	19
7 Eine Analyse durchführen	21
8 Einzelgefäßanalyse	22
8.1 Wizard-Schritt 1: Serienauswahl	22
8.2 Wizard-Schritt 2: Frameauswahl	22
8.3 Wizard-Schritt 3: Pfadlinie.....	24
8.4 Wizard-Schritt 4: Konturen.....	24
8.5 Wizard-Schritt 5: Referenz.....	25
8.6 Wizard-Schritt 6: Stent	27
8.7 Bericht	27
9 Monoplanare Ventrikelanalysen	28

9.1	Wizard-Schritt 1: Serienauswahl	28
9.2	Wizard-Schritt 2: ED-Orientierungspunkte	28
9.3	Wizard-Schritt 3: ES-Orientierungspunkte	29
9.4	Wizard-Schritt 4: ED-Kontur	29
9.5	Wizard-Schritt 5: ES-Kontur	30
9.6	Wizard-Schritt 6: Ergebnisse	31
9.7	Bericht	31
10	Biplanare Ventrikelanalysen	32
10.1	Wizard-Schritt 1: Serienauswahl	32
10.2	Wizard-Schritt 2: ED-Konturen	32
10.3	Wizard-Schritt 3: ES-Konturen	33
10.4	Wizard-Schritt 4: Ergebnisse	34
10.5	Bericht	34

1 Über QAngio XA

QAngio XA ist die Medis-Lösung zur Quantifizierung von Herzkranzgefäßen und Ventrikeln des Herzens in Röntgenangiogrammen.

Diese Softwarelösung bietet Quantifizierungsergebnisse, mit denen interventionelle Kardiologen und Radiologen Röntgenangiogramme überprüfen können, und bietet eine solide Grundlage für die Bewertung neuer Therapien.

2 Systemanforderungen

2.1 Hardware

QAngio XA:

- Intel oder kompatibler Quad-Core-Prozessor
- 4 GB RAM
- 250 GB verfügbarer Festplattenspeicher, (wenn Sie Bilder lokal speichern möchten, stellen Sie sicher, dass Sie über genügend Speicherplatz verfügen)
- 3-Tasten-Maus, Scrollrad empfohlen
- CD-ROM-Laufwerk zum Installieren der Software von der CD-ROM
- Breitbildmonitor mit einer Mindestauflösung von 1920 x 1080 Pixel
- Grafikkarte, die OpenGL unterstützt und über 512 MB Speicher verfügt
- Netzwerkkarte mit mindestens 100 MBit/s für den Zugriff auf, den Empfang und das Senden von Bildern über das Netzwerk

Sentinel-Lizenzserver:

- Intel oder kompatibler Prozessor mit einer Mindestgeschwindigkeit von 550 MHz
- 128 MB RAM
- 1 GB verfügbarer Festplattenspeicher
- Netzwerkkarte

BEMERKUNGEN:

- Die gesamte Hardware muss mit dem Betriebssystem kompatibel sein
- Für den Lizenzserver wird dringend ein PC mit einer festen IP-Adresse oder einer reservierten IP-Adresse im DNS-Server empfohlen

2.2 Betriebssystem

QAngio XA:


- Microsoft Windows 10, 64-Bit-Version
- Microsoft Windows Server 2012 R2, 64-Bit-Version
- Microsoft Windows Server 2016, 64-Bit-Version
- Microsoft Windows Server 2019, 64-Bit-Version

Sentinel-Lizenzserver:

- Microsoft Windows 10, 32- und 64-Bit-Version
- Microsoft Windows Server 2012 R2, 64-Bit-Version
- Microsoft Windows Server 2016, 64-Bit-Version
- Microsoft Windows Server 2019, 64-Bit-Version

3 Kundendienst

Medis hat es sich zur Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertige Produkte und Services anzubieten. Falls Sie Fragen zur Software haben oder uns Vorschläge zur Verbesserung der Software oder der Dokumentation unterbreiten möchten, können Sie sich gerne an den Kundendienst von Medis wenden.

Wenn Sie den Helpdesk von Medis per E-Mail kontaktieren, sollten Sie den Namen der Software und die Versionsnummer im Betreff-Feld erwähnen. Um die Versionsnummer Ihrer Software nachzuschlagen, wählen Sie in der Hauptwerkzeugleiste der Medis Suite  > **Hilfe** > **Info**.

Nordamerika und Südamerika

Medis Medical Imaging Systems, Inc.
E-Mail: support@medisimaging.com
Telefon: +1 919 278 7888 (werktags 9.00-17.00 Uhr EST)

Europa, Afrika, Asien und Australien

Medis Medical Imaging Systems B.V.
E-Mail: support@medisimaging.com
Telefon: +31 71 522 32 44 (werktags 9.00-17.00 Uhr MEZ)

4 Start aus der Medis Suite

Um Ihren Bildverarbeitungsworkflow zu verbessern, wird QAngio XA von Medis Suite in verschiedenen Analysemodi gestartet. Jeder Modus bietet Ihnen verschiedene Bildanalysefunktionen mit speziellen Funktionen und Ansichtsfenster-Layouts.

Die folgenden Startmodi für QAngio XA sind in Medis Suite verfügbar:



QCA Single Vessel: Einzelgefäßanalyse bei monoplanaren XA-Bildaufnahmen



QVA Single Vessel: periphere Einzelgefäßanalyse bei monoplanaren XA-Bildaufnahmen



LV-Monoplane: Analyse des linken Ventrikels bei monoplanaren XA-Bildaufnahmen (RAO 30)



LV-Biplane: Analyse des linken Ventrikels bei biplanaren XA-Bildaufnahmen (RAO 30 + LAO 60, oder RAO 0 + LAO 90)



RV-Biplane: Analyse des rechten Ventrikels bei biplanaren XA-Bildaufnahmen (RAO 30 + LAO 60, oder RAO 0 + LAO 90)



Die Verfügbarkeit der verschiedenen Analysen hängt von den Lizenzen ab. Wenn Sie eine Lizenz für eines oder mehrere der QAngio-XA-Analysemodule erwerben möchten, wenden Sie sich bitte an Medis.



Sie können die Patientenbilder vor oder nach dem Start von QAngio XA laden. In beiden Fällen werden die Bilder automatisch in QAngio XA geladen.


Detaillierte Informationen zum Starten der QAngio-XA-App und zum Laden von Bildern finden Sie im Medis-Suite-Benutzerhandbuch.

5 QAngio XA Arbeitsbereich


5.1 Übersicht

Das Hauptarbeitsbereichsfenster von QAngio XA besteht aus Werkzeugleisten, Arbeitsbereichsfenstern und dem zentralen Fensterbereich mit den Bildansichtsfenstern. Das Layout des Arbeitsbereichsfensters unterscheidet sich bei den verschiedenen QAngio-XA-Startmodi. Dies hängt von der Art der als Eingabe für die Analysen verwendeten Erfassungen (mono- oder biplanar) und dem ausgewählten Analysemodul ab.

In diesem Bildschirmfoto sehen Sie das Layout für die QCA-Einzelgefäßanalyse:

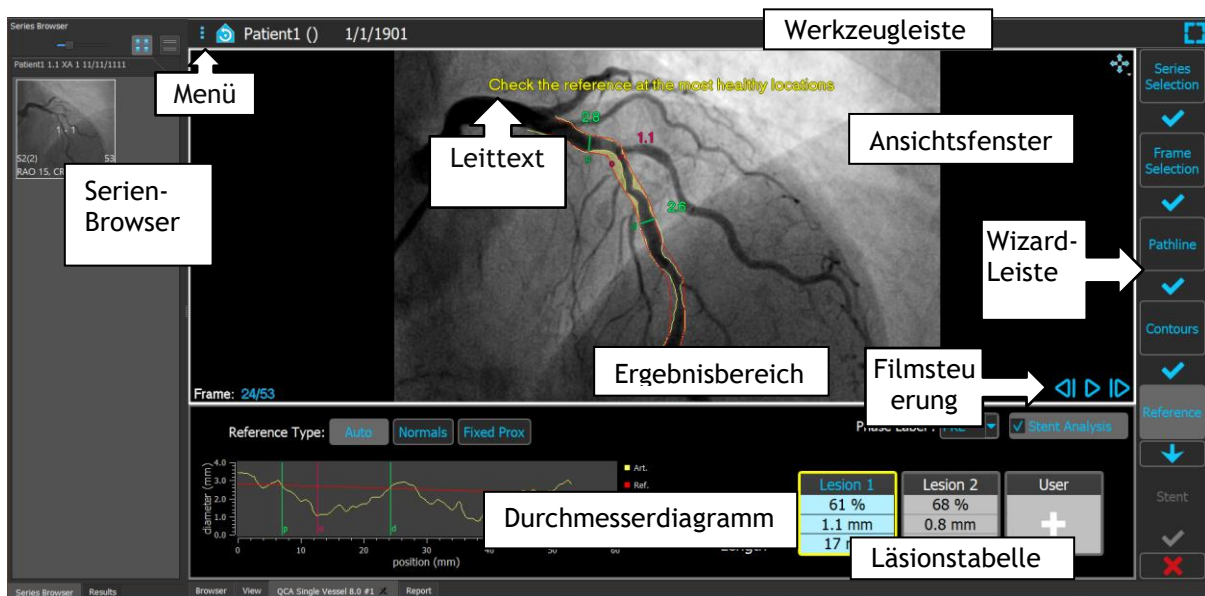

In diesem Bildschirmfoto sehen Sie das Layout für die Biplanare Analyse des linken Ventrikels:

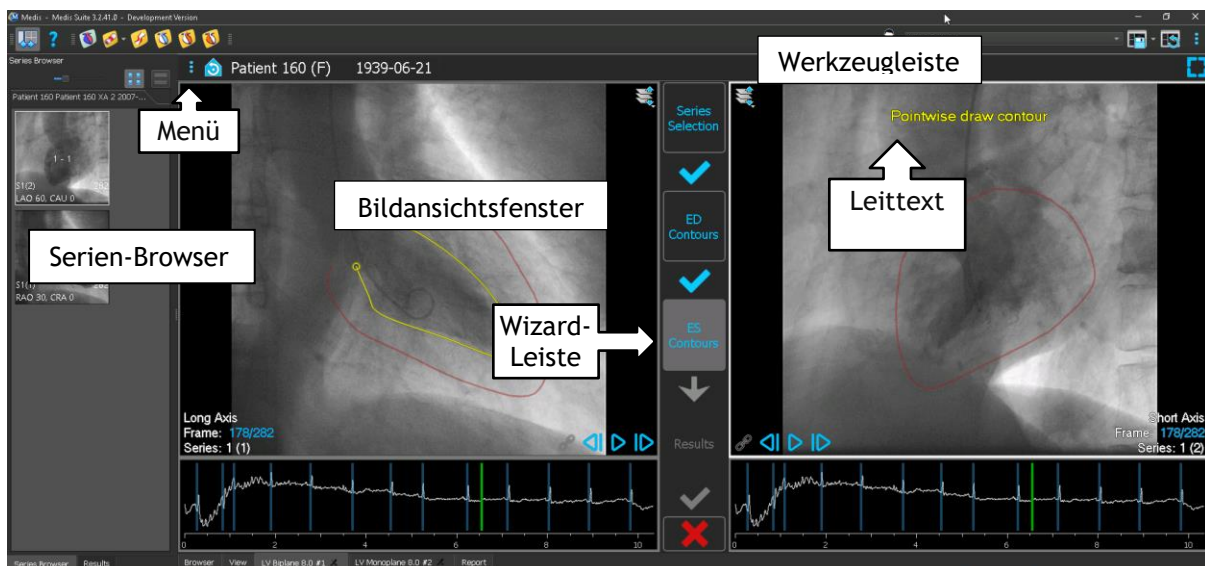

5.2 Menü


Das Menü enthält Befehle zum Aktivieren der Anwendungsfunktionalität.

So machen Sie das Menü sichtbar:

- Klicken Sie auf das Menüsymbol  in der Werkzeugleiste der QAngio-XA-App.

5.3 Werkzeugleiste

Das Bild unten zeigt die Werkzeugleiste, die in QAngio XA verfügbar ist.



Die Werkzeugleiste enthält die Schaltfläche zum Anzeigen des Menüs, des Patientennamens und des Geburtsdatums sowie optionale Informationen und/oder Schaltflächen.

6 Betrachten

6.1 Monoplanare und biplanare Ansicht

QAngio XA kann in verschiedenen Analysemodi gestartet werden. Die **QCA-Einzelgefäßanalyse** und die **monoplanare LV-Analyse** erfordern eine einzelne monoplanare Erfassung als Eingabe und bieten daher ein einzelnes Ansichtsfenster. Die **biplanaren LV- und RV-Analysen** erfordern eine biplanare Erfassung (oder zwei übereinstimmende monoplanare Erfassungen) und bieten daher zwei Ansichtsfenster.

6.2 Bild-Ansichtsfenster

6.2.1 Biplanare Ansicht

So maximieren Sie ein Bild im Ansichtsfenster:

- Doppelklicken Sie auf das Bild.

Dadurch wird das Bild maximiert, sodass es das gesamte Ansichtsfenster einnimmt.

Doppelklicken Sie erneut auf das Bild, um zum ursprünglichen Ansichtsfenster-Layout zurückzukehren.

6.2.2 Mausmodus







Das Verhalten der linken Maustaste hängt vom Mausmodus ab: Animation, Zoomen, Schwenken oder Fensterbreite und -ebene. Der aktive Mausmodus wird mit dem Mausmodus-Symbol in der oberen Ecke des Bildansichtsfensters angezeigt.

So wechseln Sie durch die verschiedenen Mausmodi:

- Wählen Sie das Mausmodus-Symbol, um den nächsten Mausmodus zu aktivieren.

6.2.3 Frameauswahl


Sie können sich auf verschiedene Arten vorwärts oder rückwärts durch Frames im Bild bewegen. Sich im ausgewählten Ansichtsfenster durch Frames zu bewegen ist nur möglich, sofern die Synchronisierung nicht aktiv ist. Die aktive Framenummer wird unten im Ansichtsfenster angezeigt.


Aktion	Schaltfläche im Ansichtsfenster	Taste auf Tastatur	Maus Scrollrad	Linke Maustaste (Animationsmodus)
Nächsten Frame auswählen		→	Herunterscrollen	Maus nach rechts oder nach unten ziehen
Vorherigen Frame auswählen		←	Nach oben scrollen	Maus nach links oder nach oben ziehen
Ersten Frame auswählen		Home		
Letzten Frame auswählen		Ende		
Animation vorwärts abspielen		Strg + →		
Animation rückwärts abspielen		Strg + ←		
Abspielen der Animation stoppen				
Synchronisierung umschalten				
Frame auswählen	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Framenummer in der unteren Ecke des Ansichtsfensters und geben Sie die Framenummer ein. z.B. 			

Wenn ein EKG-Diagramm vorhanden ist, können Sie Bilder auch durch Ziehen des EKG-Markers oder durch Klicken in das EKG-Diagramm auswählen.

6.2.4 Synchronisierung korrespondierender biplanarer Bilder

Mithilfe der Framesynchronisierung können Sie in beiden Ansichtsfenstern gleichzeitig durch Bilder navigieren. Dies ist nur bei biplanaren Erfassungen möglich.

Bei der Synchronisierung wird das Symbol  im unteren Teil des Ansichtsfensters angezeigt. In beiden Ansichtsfenstern wird immer das Bild mit derselben Framenummer angezeigt.

Wenn nicht synchronisiert wird, wird das Symbol  im unteren Teil des Ansichtsfensters angezeigt oder es wird überhaupt kein Symbol angezeigt. Das Ändern der Frameauswahl in einem Ansichtsfenster wirkt sich nicht auf das andere Ansichtsfenster aus.

In den biplanaren LV- und RV-Modi kann die Synchronisierung nicht ein- oder ausgeschaltet werden. Sie ist für biplanare Erfassungen immer aktiviert und für monoplanare Erfassungen immer deaktiviert.

6.2.5 Bild invertieren

Um die Bildansicht zu invertieren, d.h. Schwarz zu Weiß und Weiß zu Schwarz zu machen:

- Wählen Sie „Bild invertieren“ aus dem Kontextmenü des Ansichtsfensters, um die Bildinvertierung umzuschalten.


6.2.6 Ausgangsansicht

So setzen Sie die Einstellungen für Zoomen, Schwenken sowie Fensterbreite und -ebene auf die Ausgangsansicht zurück:

- Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf , um das Zoomen, Schwenken sowie die Fensterbreite und -ebene und die Bildinvertierung zurückzusetzen.

6.3 EKG

Beim Schritt der Frameauswahl des QCA-Einzelgefäß-Wizards, den Orientierungspunkte- und Konturschritten des LV-Monoplanar-Wizards und den Konturschritten der LV- und RV-Biplanar-Wizards wird das EKG-Diagramm unter dem Bild angezeigt. Wenn EKG-Daten in den Bilddaten enthalten sind, wird die EKG-Kurve im Diagramm angezeigt.

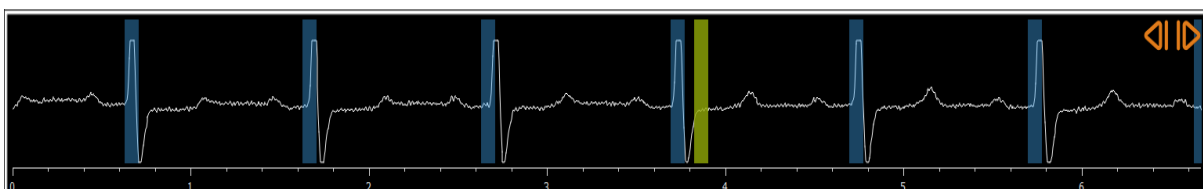

Auf der x-Achse wird die Zeit in Sekunden angezeigt. Der gelb/grüne vertikale Balken zeigt den ausgewählten Frame an, der im entsprechenden Bildansichtsfenster sichtbar ist. Die blauen Balken zeigen die Frames an, die den automatisch erkannten ED-Phasen entsprechen.



So wählen Sie einen Frame anhand des EKG-Diagramms aus:




- Ziehen Sie die grüne vertikale Leiste an die gewünschte Position.

Oder:

- Klicken Sie in das EKG-Diagramm, um den vertikalen Balken (und damit den zugehörigen Frame auszuwählen) direkt an der gewünschten Position zu platzieren.

Oder:









- Klicken Sie auf , um dieselbe Phase im vorherigen Herzzyklus auszuwählen.
- Klicken Sie auf , um dieselbe Phase im nächsten Herzzyklus auszuwählen.

 Die Schaltflächen  und  sind in den Schritten ES-Orientierungspunkte und ES-Kontur(en) nicht verfügbar.

7 Eine Analyse durchführen

Um eine Analyse zu starten, wählen Sie den entsprechenden Startmodus in Medis Suite aus (siehe auch Kapitel 4). Alle in Medis Suite verfügbaren XA-Bilder, die für die Analyse geeignet sind, werden automatisch in QAngio XA geladen. Die Analyse beginnt im Schritt Serienauswahl, in dem die verfügbaren kalibrierten XA-Bilder als Miniaturansichten unter dem Bildansichtsfenster angezeigt werden.

In allen Analysen wird eine Wizard-Leiste angezeigt, in der die Schritte der Analyse angezeigt werden. Die Wizard-Leiste der QCA-Einzelgefäßanalyse ist beispielsweise:

Wizard-Leiste	
	Schaltflächen mit blauem Text auf dunklem Hintergrund zeigen abgeschlossene Schritte an. Jede dieser Schaltflächen kann gedrückt werden, um zum entsprechenden Wizard-Schritt zu springen.
	Die Schaltfläche mit blauem Text auf grauem Hintergrund zeigt den aktiven Schritt an.
	Die Schaltfläche mit dem blauen Pfeil kann gedrückt werden, um mit dem nächsten Schritt der Analyse fortzufahren. Diese Schaltfläche ist nur aktiviert, wenn alle erforderlichen Daten für den aktiven Wizard-Schritt verfügbar sind.
	Das blaue Häkchensymbol zeigt an, dass der Übergang im Workflow vom Schritt über dem Symbol zum Schritt unter dem Symbol abgeschlossen wurde.
	Schaltflächen mit grauem Text auf dunklem Hintergrund sind deaktiviert. Der Wizard-Schritt wurde nicht ausgeführt.
	Klicken Sie auf die Schaltfläche Abbrechen, um die Analyse abzubrechen und alle Änderungen zu verwerfen. Wenn Sie bei einer neuen Analyse die Analyse abbrechen, wird die QAngio XA-App geschlossen und aus der Medis-Suite-Sitzung entfernt.
	Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertigstellen, um die Analyse abzuschließen. Der Wizard wird geschlossen und QAngio XA zeigt die Analyse im Überprüfungsmodus an. Die Analyseergebnisse werden im Medis-Suite-Bericht verfügbar.
	Wenn Sie im aktuellen Wizard-Schritt den Frame der Analyse nicht ändern können, wird der Wizard durch Aktivieren eines anderen Frames angehalten. Die Schaltfläche Fortsetzen wird unten in der Wizard-Leiste angezeigt. Wählen Sie diese Option aus, um den Frame der Analyse zu aktivieren und die Analyse fortzusetzen.

Wenn Sie eine Medis-Suite-Sitzung mit QAngio XA-Analysen neu laden, werden diese wiederhergestellt und QAngio XA wird im Überprüfungsmodus aktiviert.

8 Einzelgefäßanalyse

8.1 Wizard-Schritt 1: Serienauswahl


Die Analyse beginnt mit dem Serienauswahlschritt. Ziel dieses Schritts ist es, ein geeignetes Bild für die Analyse auszuwählen.

QAngio XA lädt nur DICOM-Graustufen-XA-Bilder mit quadratischen Pixeln (Pixel-Seitenverhältnis 1: 1), die entweder manuell in Medis Suite kalibriert wurden oder isozentrische Kalibrierungsdaten enthalten.

So wählen Sie die zu analysierende Serie aus:

- Klicken Sie auf ein Miniaturbild unter dem Ansichtsfenster.


Das Bild wird in das Ansichtsfenster geladen.


Drücken Sie , um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

8.2 Wizard-Schritt 2: Frameauswahl

Das Ziel des Schritts Frameauswahl besteht darin, einen zu analysierenden Frame auszuwählen. Es wird empfohlen, einen Frame auszuwählen, der sich in (oder kurz vor) der enddiastolischen (ED) Phase des Herzzyklus befindet.

Wenn ein EKG-Signal mit den Bilddaten verfügbar ist, wird es in einem Diagramm unter dem Bildansichtsfenster angezeigt.


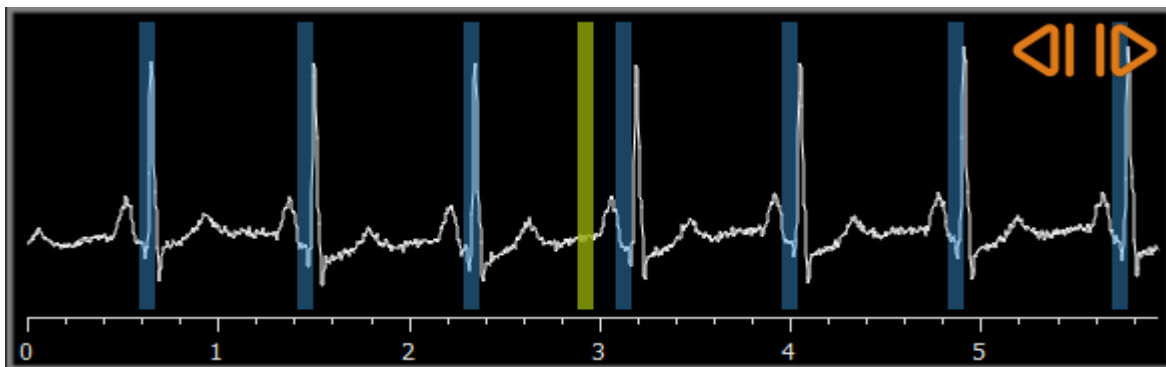



Wählen Sie den zu analysierenden Frame aus und drücken Sie , um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

8.2.1 Subtraktion


Bei der QVA-Einzelgefäßanalyse ist es möglich, auf dem analysierten Bild eine Subtraktion durchzuführen. Ein weiteres Bild (das Maskenbild) der gleichen Serie wird vom Analysebild subtrahiert, optional mit Pixelverschiebung.


Um die Subtraktion anzuwenden:

1. Klicken Sie auf .
2. Wählen Sie das richtige Maskenframe aus, entweder durch  oder durch Ziehen des violetten Maskenframe-Balkens im EKG-Diagramm:

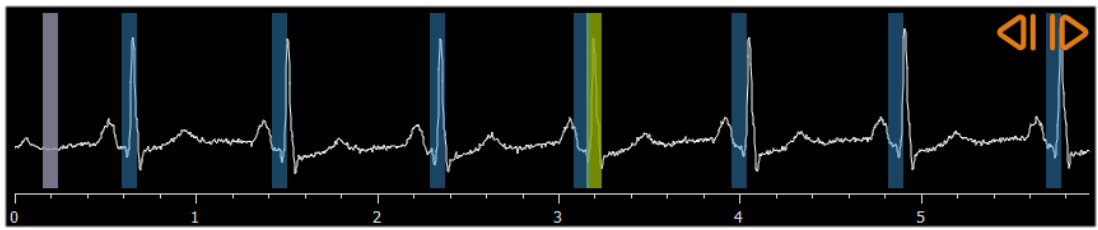

Um das aktuell ausgewählte Frame zum Maskenframe zu machen und das ursprüngliche Maskenframe als Analyseframe auszuwählen, klicken Sie auf **Frames wechseln**.

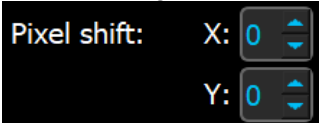3. Ändern Sie bei Bedarf die Pixelverschiebung, entweder
 - mit den Steuerelementen , oder
 - durch STRG+Pfeiltasten, oder
 - durch Klicken in das Bild in der Nähe eines Rands. Ein Pfeil erscheint, wenn die Maus über das Bild in der Nähe eines Rands bewegt wird:

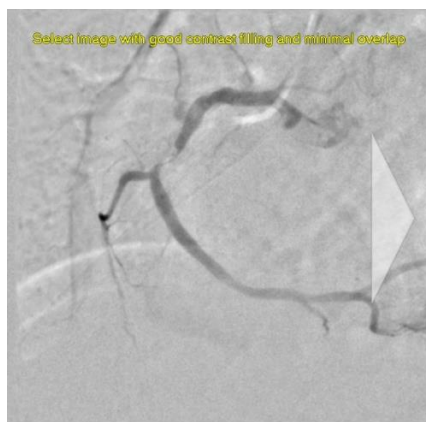

Um zu der Situation ohne Pixelverschiebung zurückzukehren, klicken Sie auf **Pixelverschiebung zurücksetzen**.



Um die Subtraktion zu deaktivieren, klicken Sie erneut auf



8.3 Wizard-Schritt 3: Pfadlinie

Das Ziel des Pfadlinienschritts besteht darin, eine Pfadlinie in dem relevanten Gefäßsegment zu erstellen.

So erstellen Sie eine Pfadlinie:


4. Klicken Sie in das Ansichtsfenster, um den proximalen Punkt des Gefäßsegments zu markieren.
5. Klicken Sie in das Ansichtsfenster, um den distalen Punkt des Gefäßsegments zu markieren. QAngio XA erkennt automatisch die Pfadlinie und Konturen.
6. Ziehen Sie bei Bedarf den proximalen oder distalen Punkt des Gefäßsegments, um deren Position zu korrigieren.

So bearbeiten Sie eine Pfadlinie:

- Klicken Sie auf einen Punkt in der Pfadlinie und ziehen Sie ihn an die richtige Position. Dadurch wird ein Pfadlinienpunkt erstellt und die Pfadlinie und die Konturen neu erkannt.
- Fügen Sie bei Bedarf weitere Pfadlinienpunkte hinzu oder ziehen Sie vorhandene Punkte an bessere Positionen.

So löschen Sie einen Pfadlinienpunkt:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Pfadlinienpunkt, um ihn zu löschen. Die Pfadlinie zwischen dem proximalen und dem distalen Punkt sowie die Konturen werden automatisch neu erkannt.

Drücken Sie , um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

8.4 Wizard-Schritt 4: Konturen


Ziel des Konturschritts ist es sicherzustellen, dass die Gefäßkonturen korrekt sind. Sie können die automatisch erkannten Konturen überprüfen und optional korrigieren. Beim ersten Aufrufen des Konturschritts wird das Bild vergrößert, um die Konturen besser sehen zu können.

So bearbeiten Sie eine Kontur:

- Klicken Sie auf einen Punkt auf der Kontur und ziehen Sie ihn an die richtige Position. Dadurch wird ein Konturpunkt erstellt und die entsprechende Kontur erneut erkannt.
- Fügen Sie bei Bedarf weitere Konturpunkte hinzu oder ziehen Sie sie an bessere Positionen.

So löschen Sie einen Konturpunkt:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Konturpunkt.
Der Punkt wird gelöscht und die entsprechende Kontur wird erneut erkannt.

Drücken Sie , um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

8.5 Wizard-Schritt 5: Referenz

Das Ziel des Referenzschritts ist es, eine korrekte Referenzdurchmesserfunktion und Läsionsmarker zu erhalten.

QAngio XA wird Folgendes bestimmen und anzeigen:

- Die Referenzkonturen, die die Gefäßkonturen anzeigen, wenn das Gefäß gesund gewesen wäre.
- Eine oder mehrere Läsionen mit jeweils einer Tabelle, in der die folgenden Läsionsparameter aufgeführt sind: prozentuale Durchmesserstenose, minimaler Lumendurchmesser (MLD) und Läsionslänge.

8.5.1 Referenzkonturen korrigieren

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Referenzkontur zu korrigieren:

- Sie können zwei gesunde Teile des Gefäßsegments als „normale Bereiche“ markieren.

Oder:

- Sie können einen festen Referenzdurchmesser für den proximalen Teil des Gefäßes in Kombination mit einem „normalen Bereich“ für den distalen Teil festlegen.

So korrigieren Sie die Referenzkonturen mit normalen Bereichen:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Normale** (über dem Diagramm), um die Referenzkonturen in den normalen Bereichsmodus zu versetzen. Im Bild und im Diagramm werden zwei normale Bereiche angezeigt.
- Klicken Sie auf die Bereiche und ziehen Sie sie an die gewünschten Positionen, entweder im Bild oder im Diagramm. Sie können die Größe der Bereiche ändern, indem Sie eine Kante ziehen. Die Referenzkonturen werden automatisch neu berechnet.

So korrigieren Sie die Referenzkonturen um einen festen proximalen Referenzdurchmesser:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Feste Prox** (über dem Diagramm), um die Referenzkonturen in den festen proximalen Referenzmodus zu versetzen. Im Bild und im Diagramm werden ein Marker (proximal) und ein normaler Bereich (distal) angezeigt.
- Passen Sie den normalen Bereich entweder im Bild oder im Diagramm an, indem Sie:
 - Den Bereich an die gewünschte Position ziehen und/oder
 - Die Größe des Bereichs durch Ziehen einer Kante verändern.Die Referenzkonturen werden automatisch neu berechnet.

8.5.2 Korrektur von Läsionsmarkern

In einem einzelnen Gefäßsegment können mehrere Läsionen erkannt werden. Die maximale Anzahl automatisch erkannter Läsionen kann in den Optionen festgelegt werden.

So korrigieren Sie die Läsionsmarker:

- Wählen Sie bei Bedarf die gewünschte Läsion aus, indem Sie auf die Läsionstabelle klicken.
- Klicken Sie auf den Obstruktionsmarker (O) und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position.
- Klicken Sie auf die proximalen (P) und distalen (D) Marker und ziehen Sie sie an die gewünschten Positionen.

So setzen Sie die Läsionsmarker auf die automatisch erkannte Position zurück:

- Wählen Sie im Kontextmenü der Läsionstabelle die Option **Läsion zurücksetzen**.

So setzen Sie alle Läsionsmarker auf die automatisch erkannte Position zurück:

- Wählen Sie im Kontextmenü der Läsionstabelle die Option **Alle Läsionen zurücksetzen**.

8.5.3 Löschen und Hinzufügen von Läsionen


So löschen Sie eine Läsion:


- Wählen Sie im Kontextmenü der Läsionstabelle die Option **Läsion löschen**.


So erstellen Sie eine benutzerdefinierte (benutzerdefinierte) Läsion:


- Klicken Sie auf die **Benutzertabelle (+)**.
- Ziehen Sie den Obstruktionsmarker (O) an die gewünschte Position
- Korrigieren Sie optional die proximalen (P) und distalen (D) Marker.

8.5.4 Akzeptieren der Analyseergebnisse oder mit der Stentanalyse fortfahren

Bei einer Einzelgefäßanalyse ohne Stent ist dies der letzte Wizard-Schritt. Drücken Sie , um den Wizard zu beenden. Die Analyseergebnisse werden jetzt im Medis Suite-Bericht verfügbar und gespeichert, wenn die Medis-Suite-Sitzung gespeichert wird. QAngio XA gibt den Überprüfungsstatus dieser Analyse ein.

Wenn Sie auch eine Stentanalyse durchführen möchten, drücken Sie . Dadurch wird der Workflow-Schritt für die Stentanalyse zur Wizard-Leiste hinzugefügt, und Sie müssen den Schritt für die Stentanalyse abschließen, bevor Sie die Analyse beenden können.

Wenn Sie  erneut drücken, wird der Workflow-Schritt für die Stentanalyse aus der Wizard-Leiste entfernt.

Drücken Sie , um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.


8.6 Wizard-Schritt 6: Stent

Ziel des Stentschritts ist es, Ihrer Analyse Stentparameter hinzuzufügen.

QAngio XA platziert die Stentmarker automatisch am proximalen und distalen Ende des Gefäßsegments - sie müssen manuell an der richtigen Position platziert werden.

So platzieren Sie die Stentmarker oder die richtigen Positionen:

- Klicken Sie auf die Stentmarker (S) und ziehen Sie sie an die gewünschten Positionen.
- Klicken Sie auf die Stentkantenbereiche und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

Drücken Sie nach Abschluss des Stentschritts im Analyse-Wizard , um den Wizard zu beenden. Die Analyseergebnisse werden jetzt im Medis-Suite-Bericht verfügbar und gespeichert, wenn die Medis-Suite-Sitzung gespeichert wird. QAngio XA gibt den Überprüfungsstatus dieser Analyse ein.

8.7 Bericht

Der Bericht in Medis Suite wird nach Abschluss der Analyse um einen Abschnitt zur Analyse einzelner Gefäße erweitert. Während der Bearbeitung einer Analyse wird der Abschnitt aus dem Bericht entfernt und nach Abschluss erneut hinzugefügt.

Details zur Berichtsfunktion finden Sie im Medis-Suite-Benutzerhandbuch.

9 Monoplanare Ventrikelanalysen

QAngio XA unterstützt die Analyse von linken Ventrikeln bei monoplanaren Erfassungen.

9.1 Wizard-Schritt 1: Serienauswahl


Die Analyse beginnt mit dem Serienauswahlschritt. Ziel dieses Schritts ist es, ein geeignetes Bild für die Analyse auszuwählen.

QAngio XA lädt nur DICOM-Graustufen-XA-Bilder mit quadratischen Pixeln (Pixel-Seitenverhältnis 1:1), die entweder manuell in Medis Suite kalibriert wurden oder isozentrische Kalibrierungsdaten enthalten, und die bei RAO 30 (± 10) erfasst wurden.

So wählen Sie die zu analysierende Serie aus:

- Klicken Sie auf ein Miniaturbild unter dem Ansichtsfenster.


Das Bild wird in das Ansichtsfenster geladen.

Drücken Sie , um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

9.2 Wizard-Schritt 2: ED-Orientierungspunkte

Das Ziel des Schritts ED-Orientierungspunkte besteht darin, den enddiastolischen Frame auszuwählen und Orientierungspunkte für die automatische Konturerkennung festzulegen.

9.2.1 Manuelle Konturen

Die Schritte für Orientierungspunkte können übersprungen werden, um manuelle Konturen zu zeichnen. In diesem Fall drücken Sie einfach  im Schritt ED-Orientierungspunkte und der Wizard fährt automatisch mit dem Schritt ED-Kontur fort.

9.2.2 ED-Frameauswahl mittels EKG


Wenn ein EKG-Signal mit den Bilddaten verfügbar ist, wird es in einem Diagramm unter dem Bildansichtsfenster angezeigt. Wenn ED-Phasen erkannt wurden, wird automatisch die mittlere ED-Phase ausgewählt.

9.2.3 Orientierungspunkte setzen

Sobald der enddiastolische Frame ausgewählt ist, platzieren Sie die Orientierungspunkte der beiden Herzklappenpunkte und den Scheitelpunkt, indem Sie auf das Bild klicken.

So ändern Sie den enddiastolischen Frame

- Wählen Sie im Kontextmenü des Bildansichtsfensters „Orientierungspunkte löschen“,
- Navigieren Sie zum gewünschten enddiastolischen Frame.
- Platzieren Sie neue Orientierungspunkte.

Drücken Sie , um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

9.3 Wizard-Schritt 3: ES-Orientierungspunkte

Das Ziel des Schritts ES-Orientierungspunkte besteht darin, den endsystolischen Frame auszuwählen und Orientierungspunkte für die automatische Konturerkennung festzulegen. Wenn ED-Orientierungspunkte festgelegt sind, müssen auch ES-Orientierungspunkte festgelegt werden, um automatische Konturen zu generieren.

9.3.1 ES-Frameauswahl

Wenn ein EKG-Signal mit den Bilddaten verfügbar ist, wird es in einem Diagramm unter dem Bildansichtsfenster angezeigt, ähnlich wie beim Schritt ED-Orientierungspunkte. Es gibt keine Tasten, um zur nächsten oder vorherigen Herzphase zu gelangen.

Es wird empfohlen, den ES-Frame im selben Herzzyklus wie den ED-Frame auszuwählen. Wenn ED-Frames automatisch erkannt wurden und im Schritt ES-Orientierungspunkte ein Frame außerhalb dieses Herzzyklus ausgewählt wird, wird ein Warntext auf dem Bild angezeigt.


Es ist nicht möglich, den ES-Frame genauso wie den ED-Frame auszuwählen.

9.3.2 Orientierungspunkte setzen

Sobald der endsystolische Frame ausgewählt ist, platzieren Sie die Orientierungspunkte der beiden Herzklappenpunkte und den Scheitelpunkt, indem Sie auf das Bild klicken.

So ändern Sie den endsystolischen Frame

- Wählen Sie im Kontextmenü des Bildansichtsfensters „Orientierungspunkte löschen“,
- Navigieren Sie zum gewünschten endsystolischen Frame,
- Platzieren Sie neue Orientierungspunkte.

Drücken Sie , um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

9.4 Wizard-Schritt 4: ED-Kontur

Das Ziel des ED-Konturschritts besteht darin, die ED-Kontur zu zeichnen oder zu korrigieren. Wenn in den Schritten ED- und ES-Orientierungspunkte entsprechend ED- und ES-Orientierungspunkte festgelegt wurden, werden in diesem Schritt automatische Konturen berechnet und angezeigt.

9.4.1 Manuelle Konturen


Wenn keine ED- und ES-Orientierungspunkte gesetzt wurden, wählen Sie den ED-Frame aus (siehe 9.2.2) und zeichnen Sie die Kontur punktweise: Klicken Sie auf mehrere Stellen im Bild und bestätigen Sie mit einem Doppelklick auf den letzten Punkt. Eine glatte Kontur durch die angeklickten Stellen wird erzeugt.

9.4.2 Konturen bearbeiten

Konturen, die automatisch generiert oder manuell gezeichnet wurden, können auf folgende Weise korrigiert werden:

- Klicken und ziehen Sie in der Nähe der vorhandenen Kontur eine geänderte Kontur. Die Änderung wird mit dem Original kombiniert.

Oder:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kontur und ziehen Sie sie mit dem Gummibandwerkzeug .

Wenn die Kontur korrekt ist, drücken Sie , um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

9.5 Wizard-Schritt 5: ES-Kontur

Das Ziel des ES-Konturschritts besteht darin, die ES-Kontur zu zeichnen oder zu korrigieren. Wenn in den Schritten ED- und ES-Orientierungspunkte entsprechend ED- und ES-Orientierungspunkte festgelegt wurden, werden in diesem Schritt automatische Konturen berechnet und angezeigt.

9.5.1 Manuelle Konturen


Wenn keine ED- und ES-Orientierungspunkte gesetzt wurden, wählen Sie den endsystolischen Frame aus (siehe 9.3.1) und zeichnen Sie die Kontur punktweise: Klicken Sie auf mehrere Stellen im Bild und bestätigen Sie mit einem Doppelklick auf den letzten Punkt. Eine glatte Kontur durch die angeklickten Stellen wird erzeugt.

9.5.2 Konturen bearbeiten

Konturen, die automatisch generiert oder manuell gezeichnet wurden, können auf folgende Weise korrigiert werden:

- Klicken und ziehen Sie in der Nähe der vorhandenen Kontur eine geänderte Kontur. Die Änderung wird mit dem Original kombiniert.

Oder:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kontur und ziehen Sie sie mit dem Gummibandwerkzeug .

Wenn die Kontur korrekt ist, drücken Sie , um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

9.6 Wizard-Schritt 6: Ergebnisse

Ziel des Ergebnisschritts ist es, die berechneten Ergebnisse anzuzeigen und zusätzliche Patientendaten einzugeben. Die berechnete Ejektionsfraktion, das ED-Volumen und das ES-Volumen werden rechts neben dem Bild angezeigt. Zusätzliche Patientendaten können unterhalb der Tabelle mit Ergebnissen eingegeben werden.

So berechnen Sie indizierte Werte:


- Geben Sie die Größe des Patienten ein und drücken Sie die Eingabetaste,
- Geben Sie das Gewicht des Patienten ein und drücken Sie die Eingabetaste.

So berechnen Sie die Herzpumpleistung:

- Geben Sie die Herzfrequenz ein und drücken Sie die Eingabetaste

So blenden Sie die Mittellinieninformationen auf dem Bild aus:

- Wählen Sie im Bildkontextmenü die Option „Mittelliniengrafiken ausblenden“ aus.

Drücken Sie , um den Wizard zu beenden. Die Analyseergebnisse werden jetzt im Medis Suite-Bericht verfügbar und gespeichert, wenn die Medis-Suite-Sitzung gespeichert wird. QAngio XA gibt den Überprüfungsstatus dieser Analyse ein.

9.7 Bericht

Der Bericht in Medis Suite wird nach Abschluss der Analyse um einen Abschnitt zur Ventrikelanalyse erweitert. Details zur Berichtsfunktion finden Sie im Medis-Suite-Benutzerhandbuch.

Während der Bearbeitung einer Analyse wird der Abschnitt aus dem Bericht entfernt und nach Abschluss erneut hinzugefügt.

10 Biplanare Ventrikelanalysen

QAngio XA unterstützt die Analyse von linken und rechten Ventrikeln bei biplanaren Bildaufnahmen (oder zwei passenden monoplanaren Erfassungen).

10.1 Wizard-Schritt 1: Serienauswahl


Die Analyse beginnt mit dem Serienauswahlschritt. Ziel dieses Schritts ist es, ein geeignetes Bild für die Analyse auszuwählen.

Eine biplanare Analyse kann nur an kalibrierten Bildern durchgeführt werden. Außerdem müssen die Bilder für die Analyse mit den folgenden Erfassungswinkeln aufgenommen worden sein:

- RAO 30, LAO 60 (± 10)
- RAO 0, LAO 90 (± 10)

So wählen Sie die zu analysierende Serie aus:

- Klicken Sie auf ein Miniaturbild unter dem Ansichtsfenster.
 - Das Bild wird in das linke Ansichtsfenster geladen.
 - Miniaturansichten übereinstimmender Bilder werden unter dem rechten Ansichtsfenster angezeigt.
- Klicken Sie auf ein Miniaturbild unter dem rechten Ansichtsfenster (wird nicht benötigt, wenn es bereits geladen ist)
 - Das Bild wird in das rechte Ansichtsfenster geladen

Drücken Sie  , um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

10.2 Wizard-Schritt 2: ED-Konturen

Das Ziel des ED-Konturschritts besteht darin, den enddiastolischen Frame auszuwählen und die ED-Konturen sowohl im Bild der Langachse als auch im Bild der Kurzachse zu zeichnen.

10.2.1 ED-Frameauswahl mittels EKG

Wenn ein EKG-Signal mit den Bilddaten verfügbar ist, wird es in einem Diagramm unter dem Bildansichtsfenster angezeigt. Wenn ED-Phasen erkannt wurden, wird automatisch die mittlere ED-Phase ausgewählt.

10.2.2 Konturen zeichnen


Wenn der enddiastolische Frame ausgewählt wurde, zeichnen Sie die Konturen sowohl in den Bildern der Lang- als auch der Kurzachse punktweise: Klicken Sie auf mehrere Stellen im Bild und akzeptieren Sie sie mit einem Doppelklick auf den letzten Punkt. Eine glatte Kontur durch die angeklickten Stellen wird erzeugt.


10.2.3 Konturen bearbeiten

Konturen können auf folgende Weise korrigiert werden:

- Klicken und ziehen Sie in der Nähe der vorhandenen Kontur eine geänderte Kontur. Die Änderung wird mit dem Original kombiniert.

Oder:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kontur und ziehen Sie sie mit dem Gummibandwerkzeug .

Wenn die Konturen korrekt sind, drücken Sie , um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

10.3 Wizard-Schritt 3: ES-Konturen

Das Ziel des ES-Konturschritts besteht darin, den endsystolischen Frame auszuwählen und die ES-Konturen sowohl im Bild der Langachse als auch im Bild der Kurzachse zu zeichnen.

10.3.1 ES-Frameauswahl

Wenn ein EKG-Signal mit den Bilddaten verfügbar ist, wird es in einem Diagramm unter dem Bildansichtsfenster angezeigt, ähnlich wie beim Schritt ED-Konturen. Es gibt keine Tasten, um zur nächsten oder vorherigen Herzphase zu gelangen.

Es wird empfohlen, den ES-Frame im selben Herzzyklus wie den ED-Frame auszuwählen. Wenn ED-Frames automatisch erkannt wurden und im Schritt ES-Konturen ein Frame außerhalb dieses Herzzyklus ausgewählt wird, wird ein Warntext auf dem Bild angezeigt.

Es ist nicht möglich, den ES-Frame genauso wie den ED-Frame auszuwählen.

10.3.2 Konturen zeichnen


Wenn der enddiastolische Frame ausgewählt wurde, zeichnen Sie die Konturen sowohl in den Bildern der Lang- als auch der Kurzachse punktweise: Klicken Sie auf mehrere Stellen im Bild und akzeptieren Sie sie mit einem Doppelklick auf den letzten Punkt. Eine glatte Kontur durch die angeklickten Stellen wird erzeugt.

10.3.3 Konturen bearbeiten

Konturen können auf folgende Weise korrigiert werden:

- Klicken und ziehen Sie in der Nähe der vorhandenen Kontur eine geänderte Kontur. Die Änderung wird mit dem Original kombiniert.

Oder:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kontur und ziehen Sie sie mit dem Gummibandwerkzeug .

Wenn die Kontur korrekt ist, drücken Sie , um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

10.4 Wizard-Schritt 4: Ergebnisse

Ziel des Ergebnisschritts ist es, die berechneten Ergebnisse anzuzeigen und zusätzliche Patientendaten einzugeben. Wählen Sie den Patiententyp: Kinder oder Erwachsene.


Die berechnete Ejektionsfraktion, das ED-Volumen und das ES-Volumen werden unter den Bildern angezeigt. Dort können zusätzliche Patientendaten eingegeben werden.

So berechnen Sie indizierte Werte:

- Geben Sie die Größe des Patienten ein und drücken Sie die Eingabetaste,
- Geben Sie das Gewicht des Patienten ein und drücken Sie die Eingabetaste.

So berechnen Sie die Herzpumpleistung:

- Geben Sie die Herzfrequenz ein und drücken Sie die Eingabetaste

Drücken Sie , um den Wizard zu beenden. Die Analyseergebnisse werden jetzt im Medis Suite-Bericht verfügbar und gespeichert, wenn die Medis-Suite-Sitzung gespeichert wird. QAngio XA gibt den Überprüfungsstatus dieser Analyse ein.

10.5 Bericht

Der Bericht in Medis Suite wird nach Abschluss der Analyse um einen Abschnitt zur Ventrikelanalyse erweitert. Details zur Berichtsfunktion finden Sie im Medis-Suite-Benutzerhandbuch.

Während der Bearbeitung einer Analyse wird der Abschnitt aus dem Bericht entfernt und nach Abschluss erneut hinzugefügt.